


# Cytiva™ Protein Select™ お客様の声・データ紹介：ご投稿画像・データ

お客様の声No. 001 理化学研究所 放射光科学研究センター 生物系ビームライン基盤グループ 竹下 浩平様

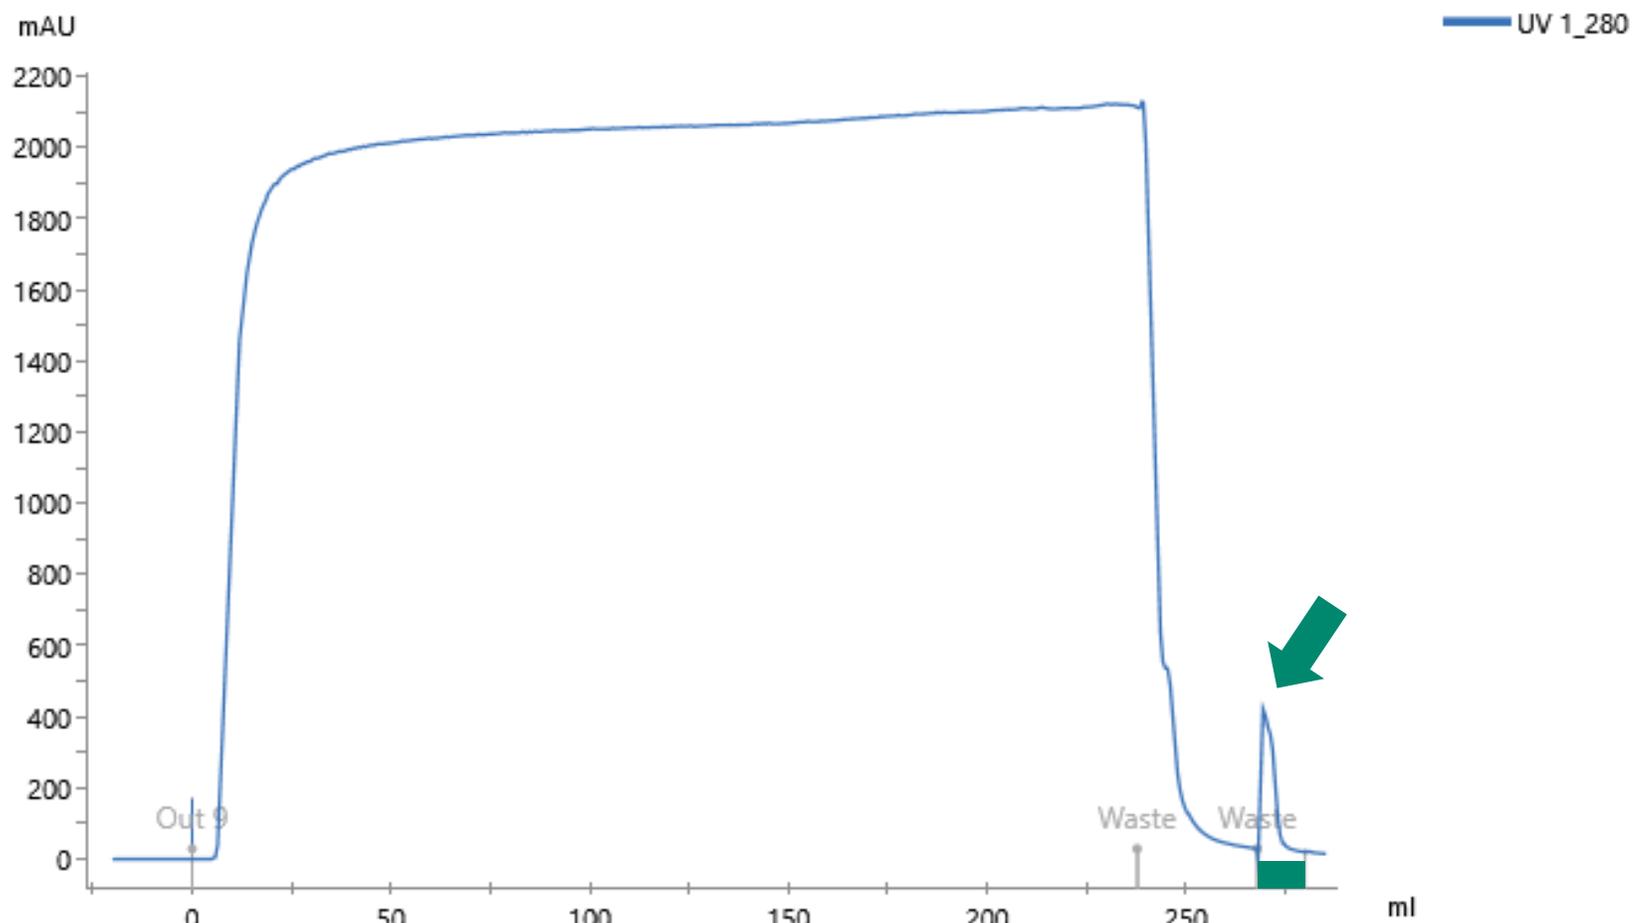


HiTrap Protein Select クロマトグラム（バーで示す部分をゲルろ過カラムへ添加）

※掲載している内容はあくまでご使用いただいたお客さまのサンプル・実験条件に基づくものであり、製品の品質を保証するものではないことをご了承ください。また、投稿いただいた内容のうち、実験手法に関する箇所は弊社推奨の使用方法を個別に検討・改善された結果を含んでいる場合があります。ご参考にされる場合は、お客さま各位の責任において実施していただきますようお願い申し上げます。

# Cytiva™ Protein Select™ お客様の声・データ紹介：ご投稿画像・データ



お客様の声No. 001 理化学研究所 放射光科学研究センター 生物系ビームライン基盤グループ 竹下 浩平様

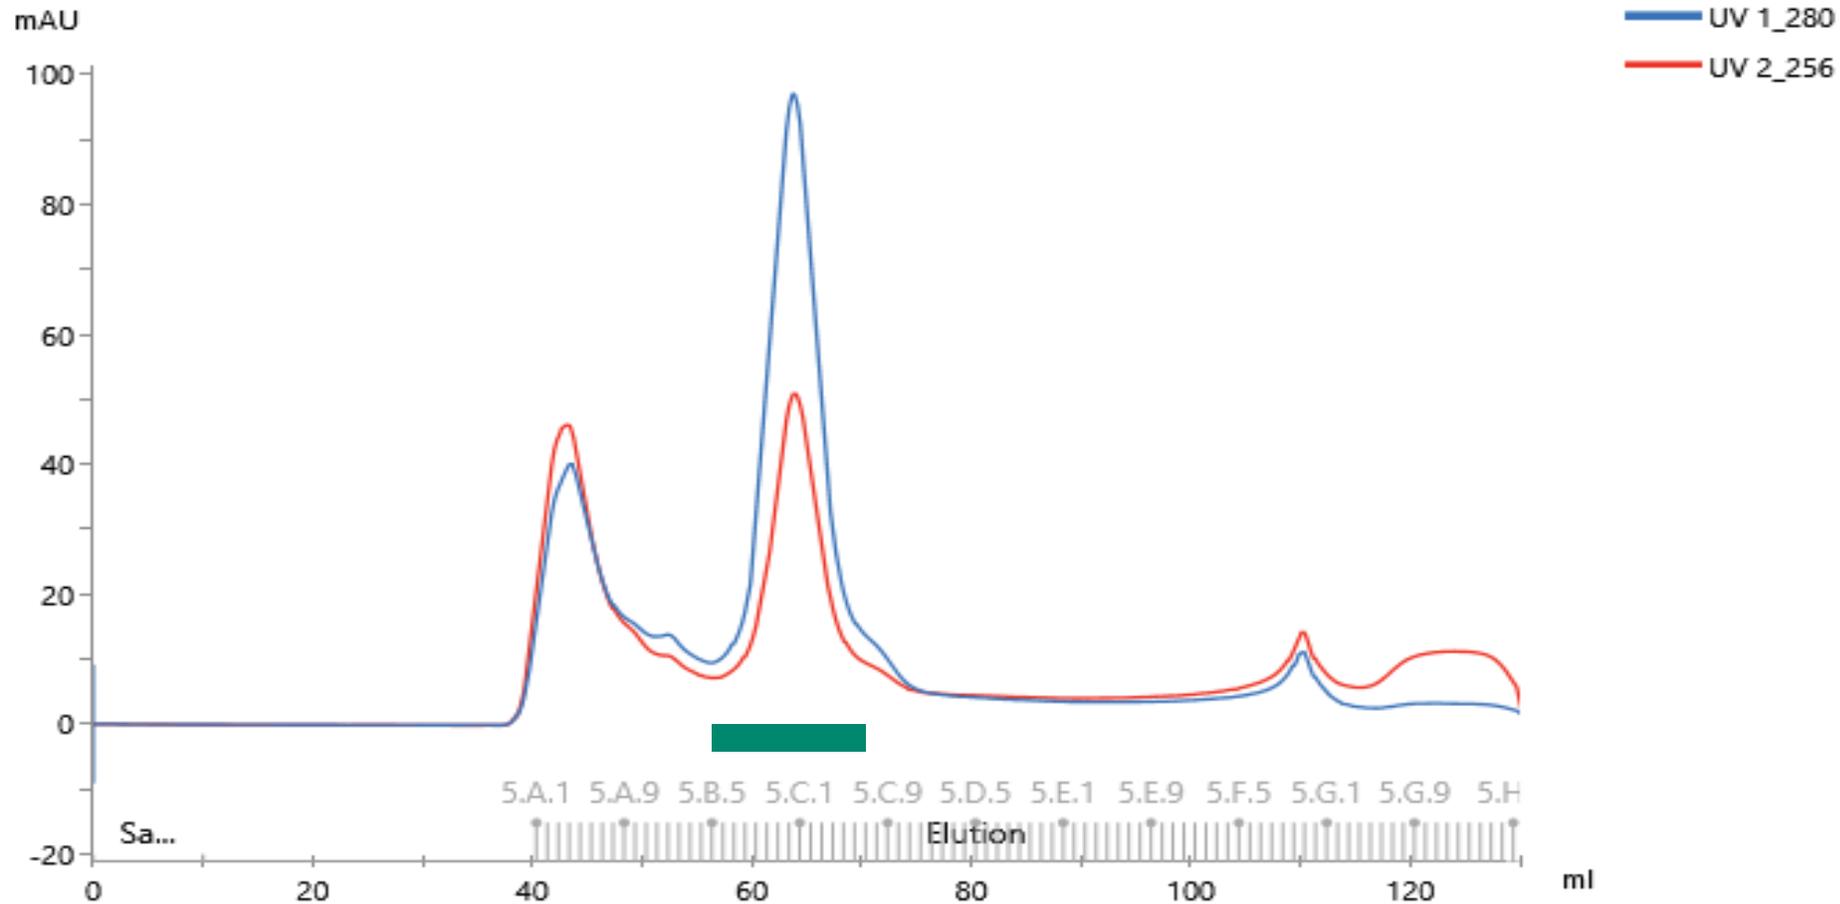


HiLoad 16/600 Superdex 75pg クロマトグラム (バーで示すフラクションをSDS-PAGEへ)

※掲載している内容はあくまでご使用いただいたお客さまのサンプル・実験条件に基づくものであり、製品の品質を保証するものではないことをご了承ください。また、投稿いただいた内容のうち、実験手法に関する箇所は弊社推奨の使用方法を個別に検討・改善された結果を含んでいる場合があります。ご参考にされる場合は、お客さま各位の責任において実施していただきますようお願い申し上げます。

<https://www.cytivalifesciences.co.jp/technologies/protein-purification/purify-products/protein-select-voc.html>

# Cytiva™ Protein Select™ お客様の声・データ紹介：ご投稿画像・データ

お客様の声No. 001 理化学研究所 放射光科学研究センター 生物系ビームライン基盤グループ 竹下 浩平様

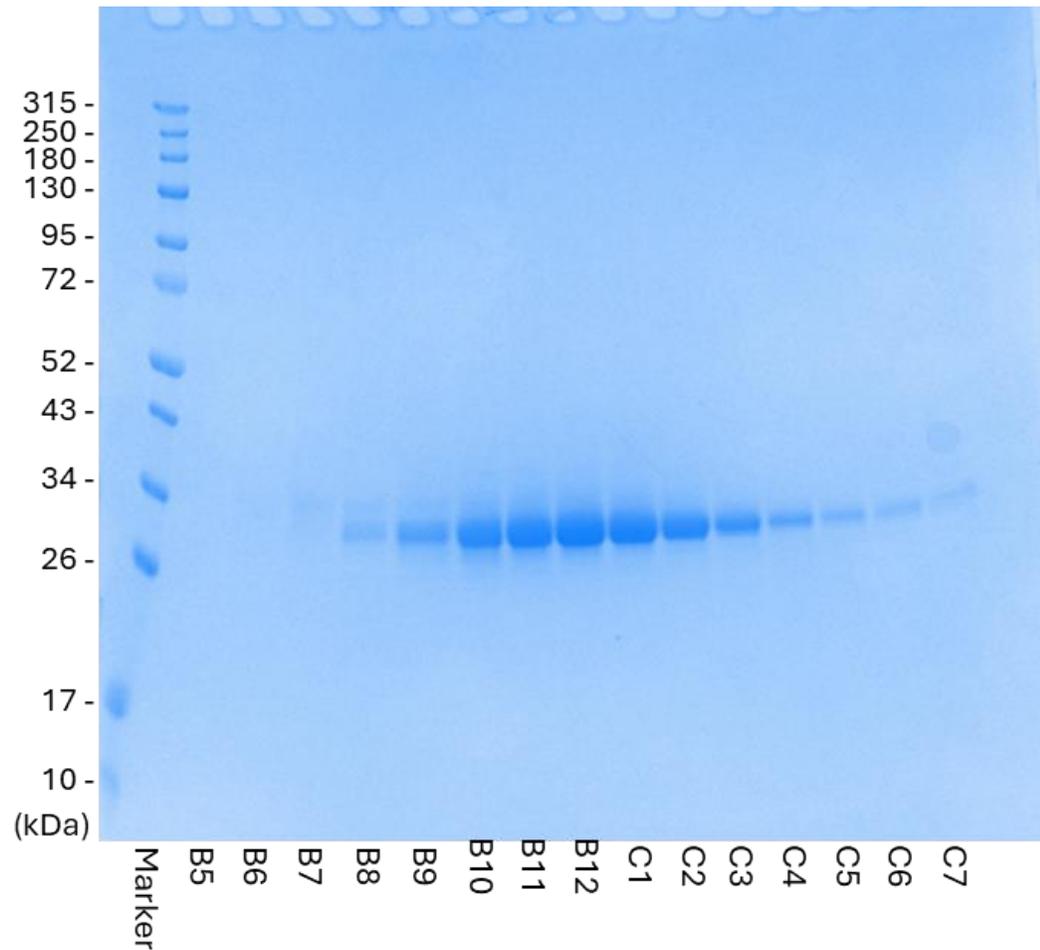

ゲルろ過フラクションのSDS-PAGE

※掲載している内容はあくまでご使用いただいたお客さまのサンプル・実験条件に基づくものであり、製品の品質を保証するものではないことをご了承ください。また、投稿いただいた内容のうち、実験手法に関する箇所は弊社推奨の使用方法を個別に検討・改善された結果を含んでいる場合があります。ご参考にされる場合は、お客さま各位の責任において実施していただきますようお願い申し上げます。